



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario: INTER DONDÉ

Equipo de inspección: OLYMPUS


No. de serie: 110855202

Fecha de calibración: 03/07/2011

No. de certificado: 2075519



ISOMÉTRICO

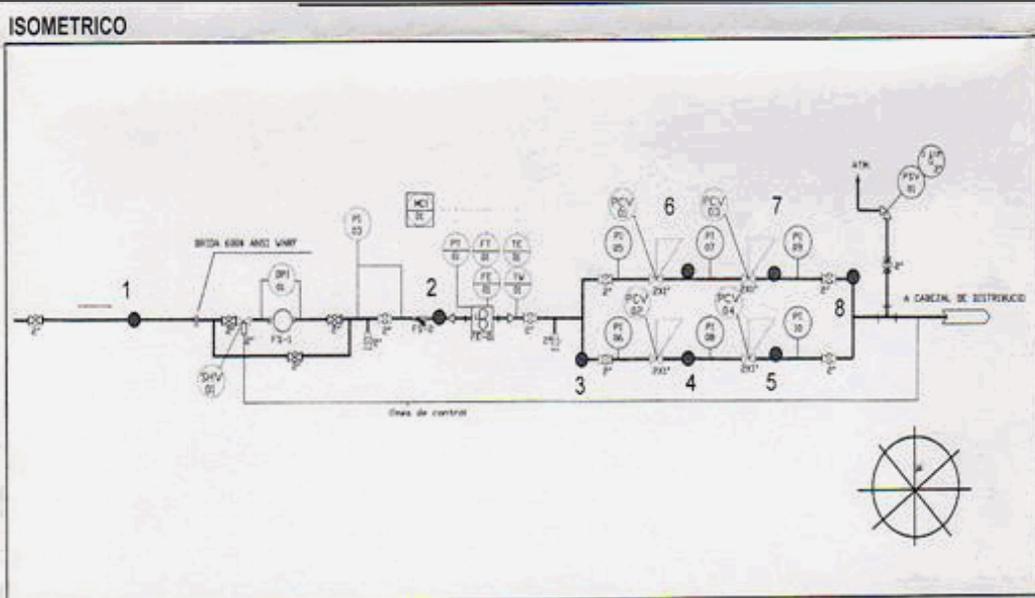

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	CARRETE	2.00000	180°	0.15500	900	0.05100
2	CARRETE	2.00000	180°	0.16000	900	0.05100
3	CODO	2.00000	180°	0.17400	900	0.05100
4	CARRETE	2.00000	180°	0.15700	640	0.03700
5	CARRETE	2.00000	180°	0.15200	360	0.02100
6	CARRETE	2.00000	180°	0.15600	640	0.03700
7	CARRETE	2.00000	180°	0.15000	360	0.02100
8	CODO	2.00000	180°	0.24400	360	0.02100

Observaciones:
 EN ORDÉN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/11/2012 05:28:53p.m.

Fecha de aprobación: 13/11/2012 05:14:08a.m.

Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna