



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA: Productos Farmaceuticos S.A. de C.V. PERIODO: 23-Apr-2015 22-Apr-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Manuel Dario Martinez Zepeda FRECUENCIA: ANUAL **RO-008**

Usuario: INTERCONEXIÓN
Equipo de inspección: olympus
No. de serie: 140510712
Fecha de calibración: 19-01-15
No. de certificado: SO-A1011060



ISOMÉTRICO

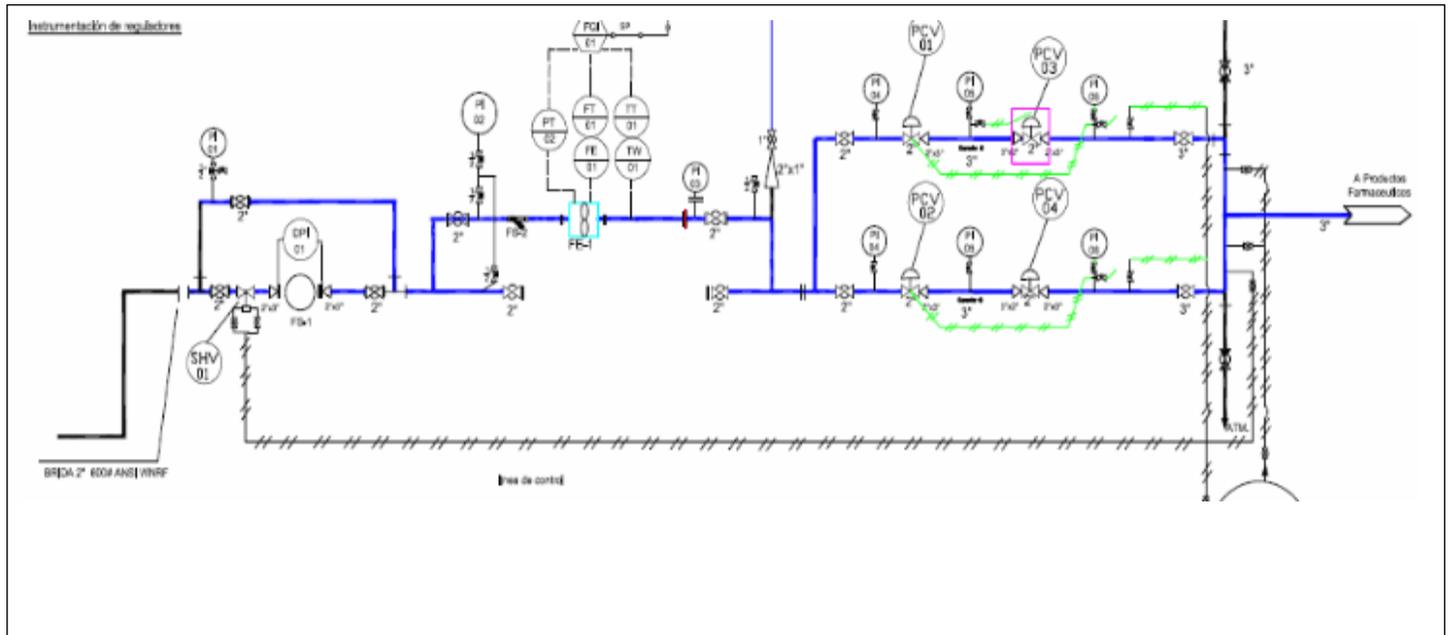

| MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| N° | Punto | Diametro Exterior (plg) | Cuadrante | Espesor (plg) | Presion de operación (psig) | Espesor mínimo requerido |
| 1 | 1 | 2.00 | 90 | 0.15 | 330 | 0.03000 |
| 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0.15 | 330 | 0.03000 |
| 3 | 3 | 2.00 | 90 | 0.15 | 330 | 0.03000 |
| 4 | 4 | 3.00 | 90 | 0.21 | 100 | 0.05000 |

Observaciones:

0

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 12-May-2016
Fecha de aprobación: 12-May-2016
Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| SISTEMA: | Productos Farmaceuticos S.A. de C.V. | PERIODO: | 23-Apr-2015 22-Apr-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Manuel Dario Martinez Zepeda | FRECUENCIA: | ANUAL | RO-008 |

Usuario: Productos Farmaceuticos CHINOIN

Equipo de inspección: Olympus


No. de serie: 140510712

Fecha de calibración: 19-ENE-201

No. de certificado: SO-A1011060



ISOMÉTRICO

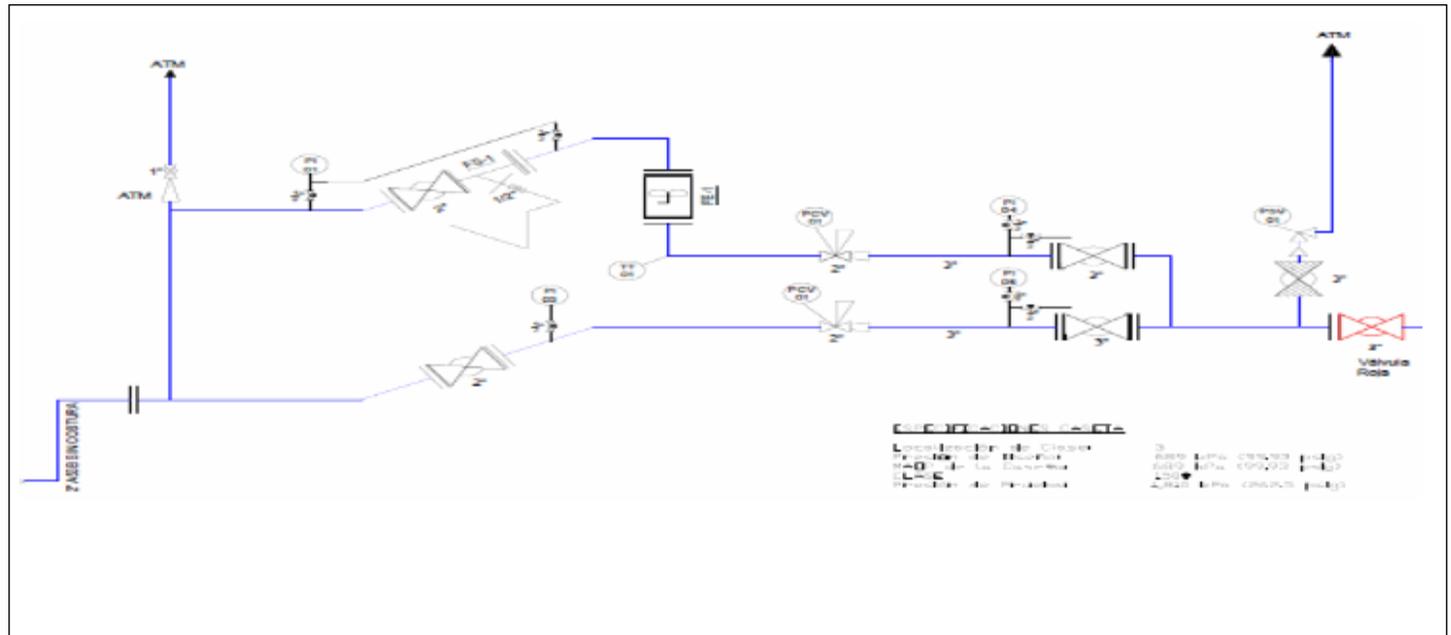

| MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPEORES EN MILESIMAS DE PULGADA | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| N° | Punto | Diametro Exterior (plg) | Cuadrante | Espesor (plg) | Presion de operación (psig) | Espesor mínimo requerido |
| 1 | 1 | 2.00 | 90 | 0.16 | 100 | 0.03000 |
| 2 | 2 | 2.00 | 90 | 0.15 | 100 | 0.03000 |
| 3 | 3 | 2.00 | 90 | 0.15 | 100 | 0.03000 |
| 4 | 4 | 3.00 | 90 | 0.21 | 45 | 0.05000 |

Observaciones:

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 12-May-2016

Fecha de aprobación: 12-May-2016

Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca